

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2 N° Evaluación : 13
 Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022 Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
 Tipo de Muestra : Suero Liofilizado Versión del Informe : V 0

Equipamiento Utilizado en Material de Control: H-13 - Hormonas

Analito	Grupo	Equipo	Marca	Modelo	Método
Cortisol	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
Estradiol	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
FSH	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
hCG	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
Insulina	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
LH	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
Parathormona (PTH)	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
Prolactina	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
T3 Total	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
T4 Libre	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
T4 Total	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
Testosterona	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
TSH	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia

Equipamiento Utilizado en Material de Control: H-13 - Vitaminas

Analito	Grupo	Equipo	Marca	Modelo	Método
Folato	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia
Vitamina B12	10	Autoanalizadores	Ortho-Clinical Diagnostics	XT-7600	Quimioluminiscencia

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
---------------------------------	-----------

Envío : Envío 2 de 2	N° Evaluación : 13	Satisfactorio IZI <= 2.0
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022	Cuestionable 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	Insatisfactorio IZI >= 3.0

Resultados del Material de Control Resumen: H-13 - Hormonas												
Analito	Resultado	Unidad	Resumen								Desempeño	Clasificado en
			n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z			
Cortisol	2,90	µg / dL	18	2,781	0,214	7,69	0,06	4,26	0,55	Satisfactorio	Equipamiento	
Estradiol	104,36	pg / mL	36	100,671	11,305	11,23	2,36	3,66	0,33	Satisfactorio	Equipamiento	
FSH	3,70	mIU / mL	40	3,710	0,237	6,39	0,05	-0,26	-0,04	Satisfactorio	Equipamiento	
hCG	8,75	mIU / mL	54	8,263	0,625	7,56	0,11	5,89	0,78	Satisfactorio	Equipamiento	
Insulina	17,90	µIU / mL	45	17,003	1,032	6,07	0,19	5,27	0,87	Satisfactorio	Equipamiento	
LH	0,98	mIU / mL	32	1,119	0,119	10,59	0,03	-12,41	-1,17	Satisfactorio	Equipamiento	
Parathormona (PTH)	18,34	pg / mL	16	20,663	2,584(c)	11,93	0,77	-11,24	-0,90(c)	Satisfactorio	Equipamiento	
Prolactina	7,94	ng / mL	33	8,257	0,442	5,36	0,10	-3,84	-0,72	Satisfactorio	Equipamiento	
T3 Total	0,91	ng / mL	50	0,926	0,056	6,09	0,01	-1,72	-0,28	Satisfactorio	Equipamiento	
T4 Libre	1,47	ng / dL	57	1,523	0,094	6,19	0,02	-3,46	-0,56	Satisfactorio	Equipamiento	
T4 Total	5,80	µg / dL	53	5,756	0,350	6,08	0,06	0,76	0,12	Satisfactorio	Equipamiento	
Testosterona	1,21	ng / mL	27	1,197	0,105	8,75	0,03	1,09	0,12	Satisfactorio	Equipamiento	
TSH	0,39	µIU / mL	57	0,373	0,041	11,04	0,01	4,54	0,41	Satisfactorio	Equipamiento	

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación

u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Resultados del Material de Control Resumen: H-13 - Vitaminas												
Analito	Resultado	Unidad	Resumen								Desempeño	Clasificado en
			n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z			
Folato	3,17	ng / mL	15	3,443	0,471(c)	13,00	0,14	-7,94	-0,58(c)	Satisfactorio	Equipamiento	
Vitamina B12	351,13	pg / mL	38	361,485	20,036	5,54	4,06	-2,86	-0,52	Satisfactorio	Equipamiento	

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación

u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2 N° Evaluación : 13
 Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022 Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
 Tipo de Muestra : Suero Liofilizado Versión del Informe : V 0

Resultados del Material de Control Equipamiento:		H-13 - Hormonas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)								
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Equipamiento							Desempeño
			n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z	
Cortisol	2,90	µg / dL	18	2,781	0,214	7,69	0,06	4,26	0,55	Satisfactorio
Estradiol	104,36	pg / mL	36	100,671	11,305	11,23	2,36	3,66	0,33	Satisfactorio
FSH	3,70	mIU / mL	40	3,710	0,237	6,39	0,05	-0,26	-0,04	Satisfactorio
hCG	8,75	mIU / mL	54	8,263	0,625	7,56	0,11	5,89	0,78	Satisfactorio
Insulina	17,90	µIU / mL	45	17,003	1,032	6,07	0,19	5,27	0,87	Satisfactorio
LH	0,98	mIU / mL	32	1,119	0,119	10,59	0,03	-12,41	-1,17	Satisfactorio
Parathormona (PTH)	18,34	pg / mL	16	20,663	2,584(c)	11,93	0,77	-11,24	-0,90(c)	Satisfactorio
Prolactina	7,94	ng / mL	33	8,257	0,442	5,36	0,10	-3,84	-0,72	Satisfactorio
T3 Total	0,91	ng / mL	50	0,926	0,056	6,09	0,01	-1,72	-0,28	Satisfactorio
T4 Libre	1,47	ng / dL	57	1,523	0,094	6,19	0,02	-3,46	-0,56	Satisfactorio
T4 Total	5,80	µg / dL	53	5,756	0,350	6,08	0,06	0,76	0,12	Satisfactorio
Testosterona	1,21	ng / mL	27	1,197	0,105	8,75	0,03	1,09	0,12	Satisfactorio
TSH	0,39	µIU / mL	57	0,373	0,041	11,04	0,01	4,54	0,41	Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coefficiente de variación

u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Resultados del Material de Control Equipamiento:		H-13 - Vitaminas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)								
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Equipamiento							Desempeño
			n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z	
Folato	3,17	ng / mL	15	3,443	0,471(c)	13,00	0,14	-7,94	-0,58(c)	Satisfactorio
Vitamina B12	351,13	pg / mL	38	361,485	20,036	5,54	4,06	-2,86	-0,52	Satisfactorio

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coefficiente de variación

u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
---------------------------------	-----------

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13	Satisfactorio IZI <= 2.0
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022	Cuestionable 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	Insatisfactorio IZI >= 3.0

Resultados del Material de Control Metodología: H-13 - Hormonas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)			Análisis por Metodología							Desempeño
Analito	Resultado	Unidad	n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z	
Cortisol	2,90	µg / dL	65	3,045	0,340	11,16	0,05	-4,77	-0,43	
Estradiol	104,36	pg / mL	111	101,803	12,591	12,37	1,49	2,51	0,20	
FSH	3,70	mIU / mL	134	4,784	0,972	20,32	0,10	-22,66	-1,12	
hCG	8,75	mIU / mL	179	7,213	1,795	24,89	0,17	21,31	0,86	
Insulina	17,90	µIU / mL	187	17,225	2,327	13,51	0,21	3,92	0,29	
LH	0,98	mIU / mL	116	1,444	0,494	34,22	0,06	-32,14	-0,94	
Parathormona (PTH)	18,34	pg / mL	51	19,757	7,064	35,76	1,24	-7,17	-0,20	
Prolactina	7,94	ng / mL	107	7,689	1,610	20,94	0,19	3,26	0,16	
T3 Total	0,91	ng / mL	200	0,845	0,122	14,40	0,01	7,76	0,54	
T4 Libre	1,47	ng / dL	234	1,172	0,291	24,79	0,02	25,40	1,02	
T4 Total	5,80	µg / dL	204	5,968	0,624	10,45	0,05	-2,82	-0,27	
Testosterona	1,21	ng / mL	74	1,497	0,412	27,53	0,06	-19,17	-0,70	
TSH	0,39	µIU / mL	236	0,436	0,078	17,81	0,01	-10,58	-0,59	

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación
u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Resultados del Material de Control Metodología: H-13 - Vitaminas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)			Análisis por Metodología							Desempeño
Analito	Resultado	Unidad	n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z	
Folato	3,17	ng / mL	36	3,422	0,789	23,07	0,16	-7,37	-0,32	
Vitamina B12	351,13	pg / mL	131	368,591	60,060	16,29	6,56	-4,74	-0,29	

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación
u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación	Desempeño
---------------------------------	-----------

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13	Satisfactorio IZI <= 2.0
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022	Cuestionable 2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	Insatisfactorio IZI >= 3.0

Resultados del Material de Control Analito: H-13		Hormonas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)								Desempeño
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Analito							
			n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z	
Cortisol	2,90	µg / dL	94	3,140	0,355	11,31	0,05	-7,65	-0,68	
Estradiol	104,36	pg / mL	151	102,357	11,889	11,62	1,21	1,96	0,17	
FSH	3,70	mIU / mL	186	4,916	0,866	17,62	0,08	-24,73	-1,40	
hCG	8,75	mIU / mL	246	6,784	1,780	26,24	0,14	28,98	1,10	
Insulina	17,90	µIU / mL	267	17,635	2,212	12,55	0,17	1,50	0,12	
LH	0,98	mIU / mL	163	1,596	0,574	35,99	0,06	-38,59	-1,07	
Parathormona (PTH)	18,34	pg / mL	78	19,152	4,844	25,29	0,69	-4,24	-0,17	
Prolactina	7,94	ng / mL	149	8,001	1,661	20,76	0,17	-0,77	-0,04	
T3 Total	0,91	ng / mL	276	0,895	0,159	17,80	0,01	1,64	0,09	
T4 Libre	1,47	ng / dL	334	1,144	0,236	20,64	0,02	28,52	1,38	
T4 Total	5,80	µg / dL	280	6,003	0,593	9,88	0,04	-3,38	-0,34	
Testosterona	1,21	ng / mL	103	1,499	0,360	24,02	0,04	-19,26	-0,80	
TSH	0,39	µIU / mL	338	0,457	0,081	17,65	0,01	-14,66	-0,83	

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación

u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Resultados del Material de Control Analito: H-13		Vitaminas evaluadas por valor consenso (estadística robusta Algoritmo A)								Desempeño
Analito	Resultado	Unidad	Análisis por Analito							
			n	X _{pt}	σ _{pt}	CV	u(X _{pt})	D%	Z	
Folato	3,17	ng / mL	43	3,327	0,702	21,11	0,13	-4,71	-0,22	
Vitamina B12	351,13	pg / mL	172	375,084	56,335	15,02	5,37	-6,39	-0,43	

n=Número de laboratorios evaluados X_{pt}=Valor asignado σ_{pt}=Desviación estándar para evaluar desempeño CV=Coficiente de variación



u(X_{pt})=Incertidumbre estándar del valor asignado D%=Desvío relativo porcentual Z=Puntuación usada para evaluar desempeño (c)=Valor corregido para σ_{pt} y Z

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : Cortisol

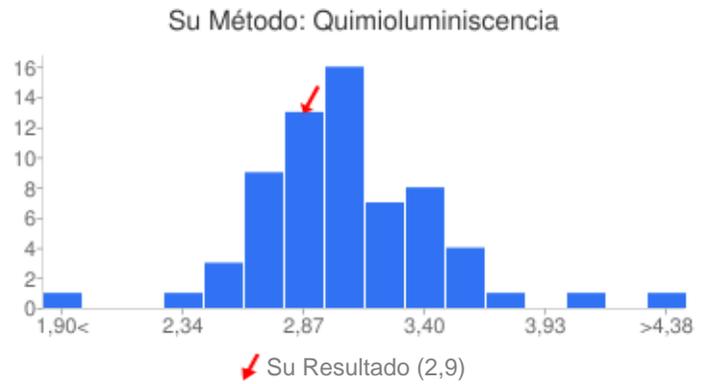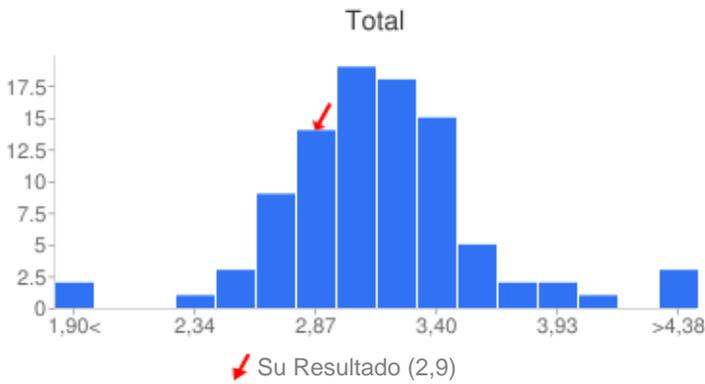

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : Cortisol

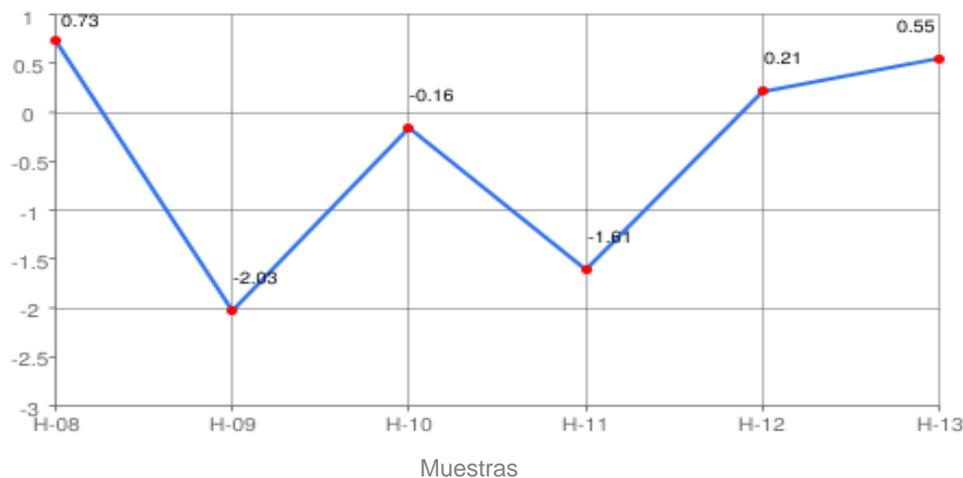

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : Estradiol



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : Estradiol

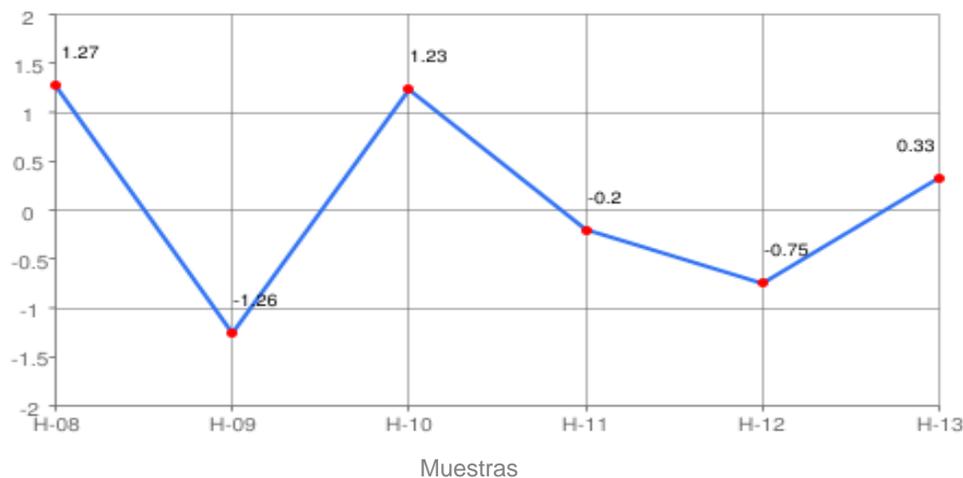


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : FSH

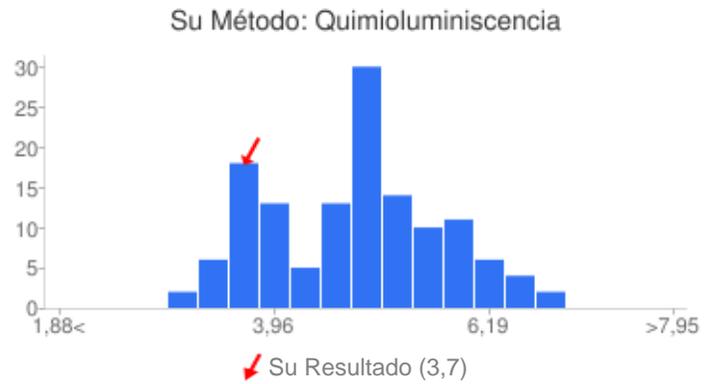

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : FSH

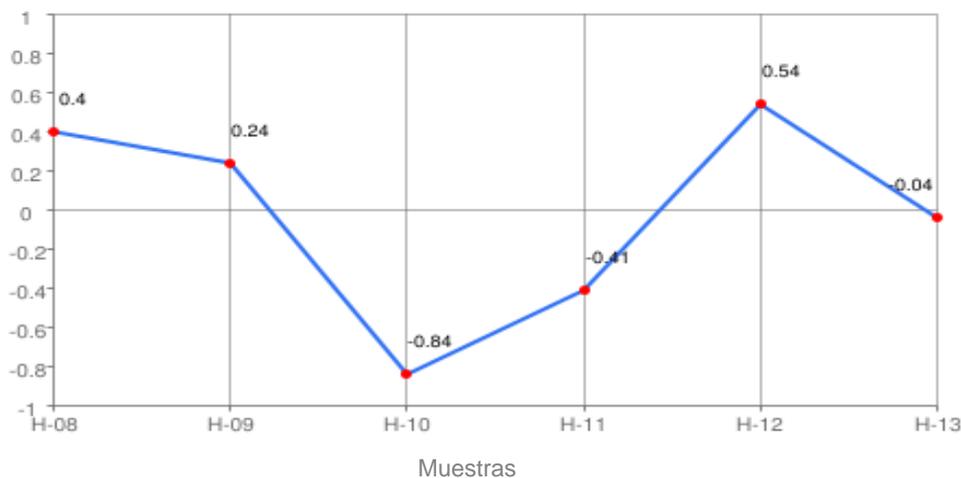

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : hCG



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : hCG

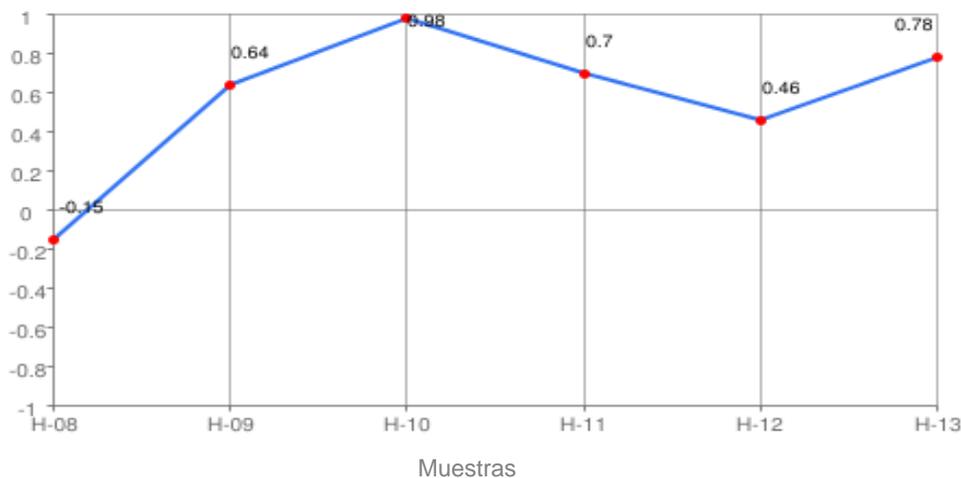

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : Insulina

Total



Su Método: Quimioluminiscencia




***Su Grupo Par: 10**



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : Insulina

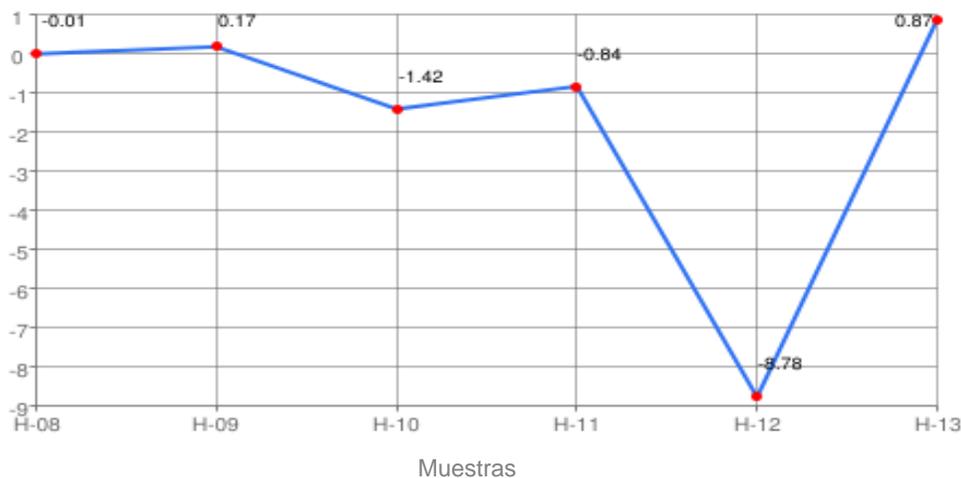

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : LH



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : LH


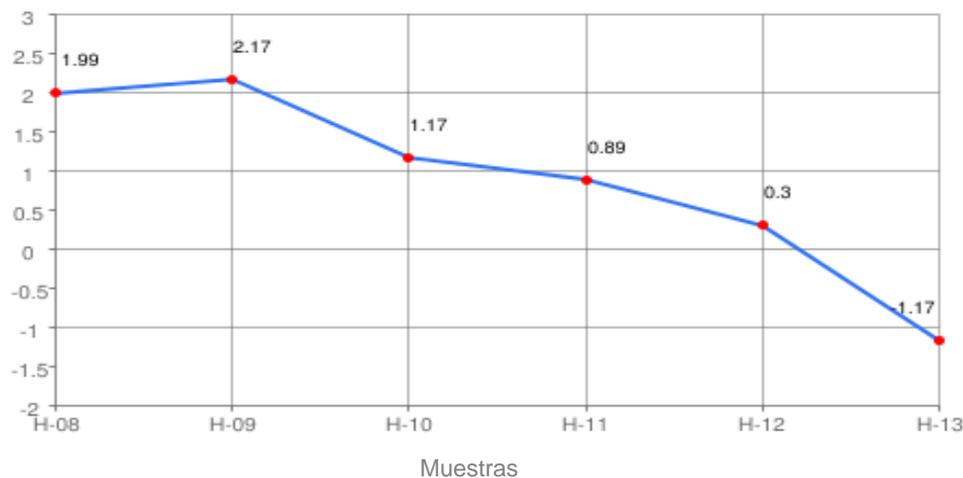


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : Parathormona (PTH)

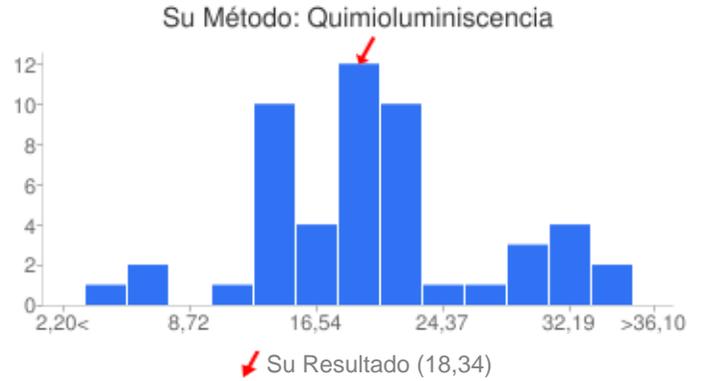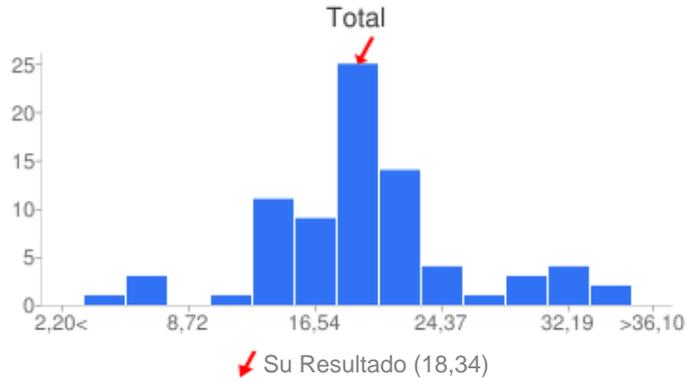

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.


Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : Prolactina

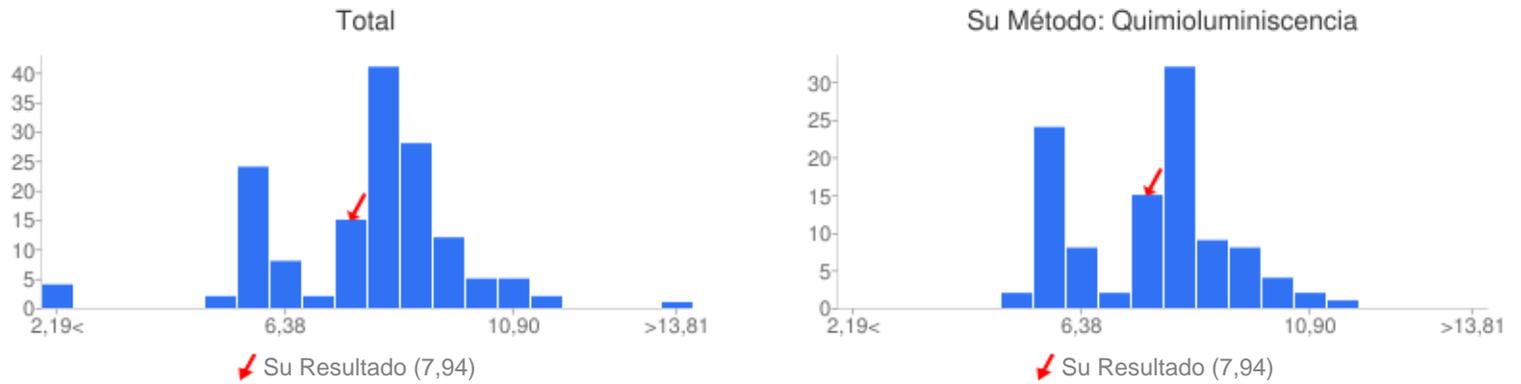

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : Prolactina

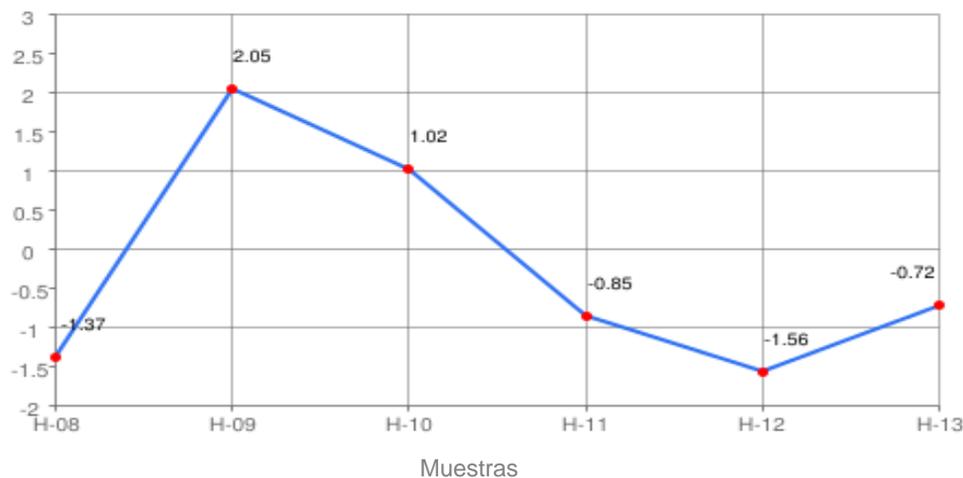


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : T3 Total

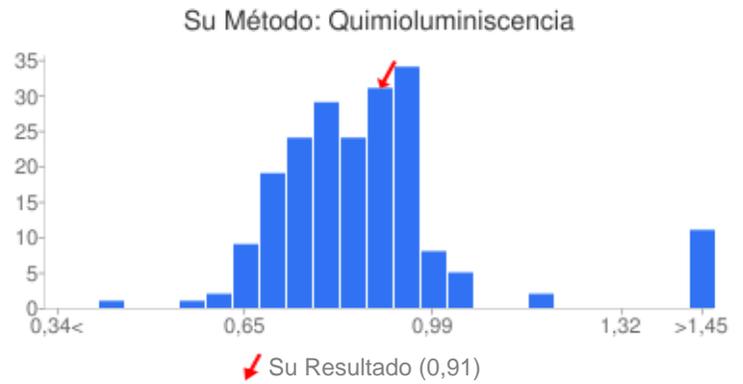

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : T3 Total

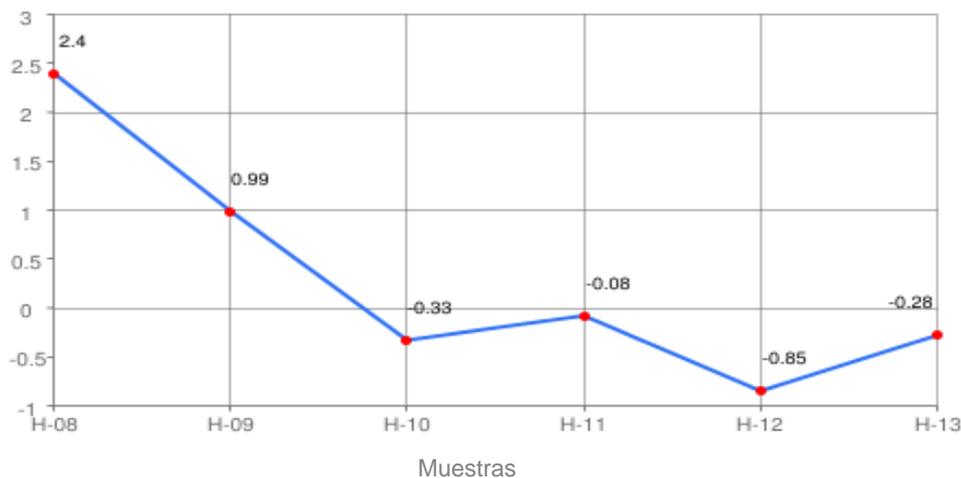

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : T4 Libre



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : T4 Libre

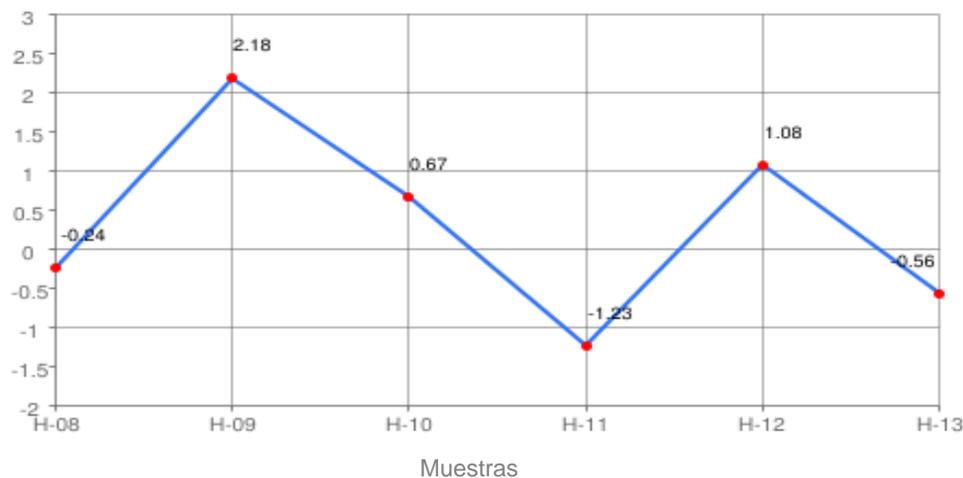


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	N° Evaluación : 13	
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022	
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0	


Gráficos Analito : T4 Total

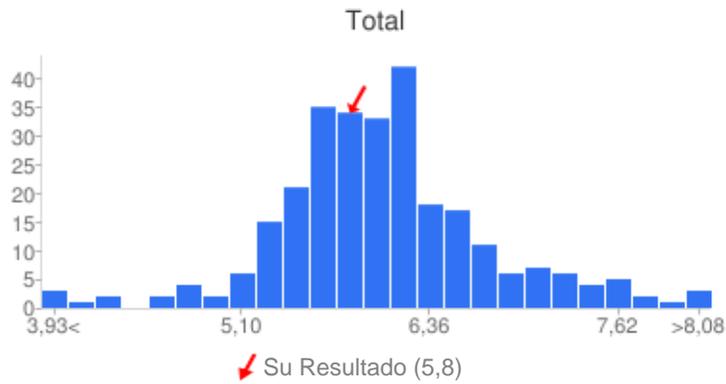

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : T4 Total

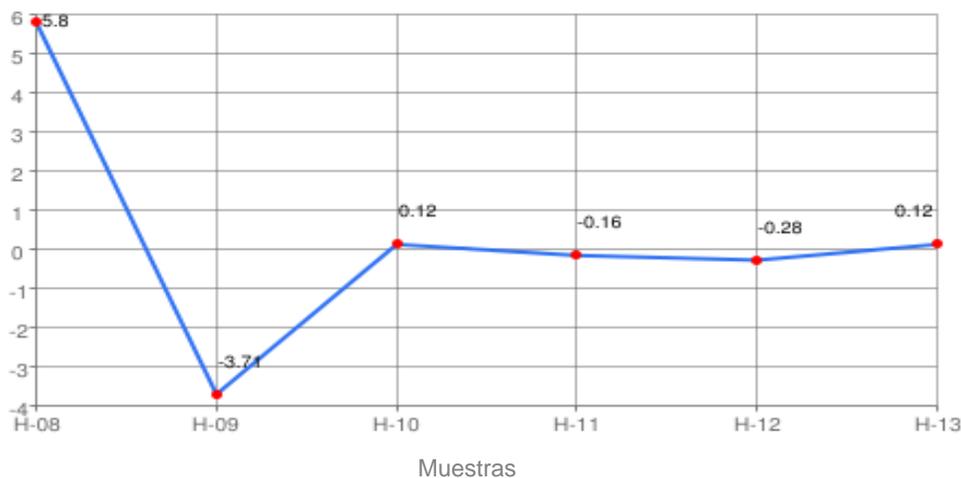


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 2 de 2	Nº Evaluación	: 13
Fecha Envío	: 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe	: 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0

Gráficos Analito : Testosterona

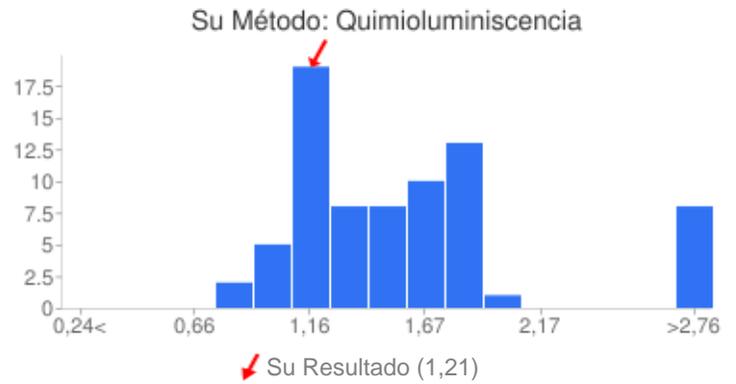

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0

Gráficos Analito : TSH


Total



Su Método: Quimioluminiscencia




*Su Grupo Par: 10

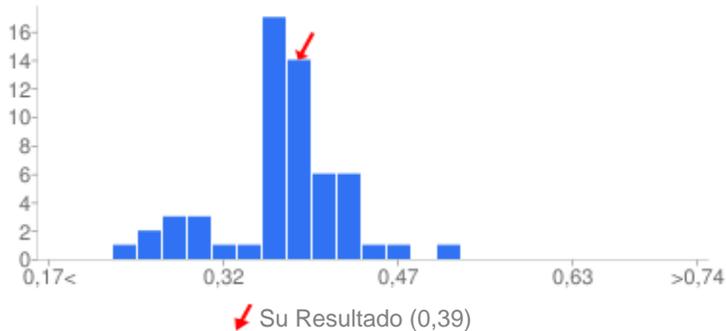

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : TSH


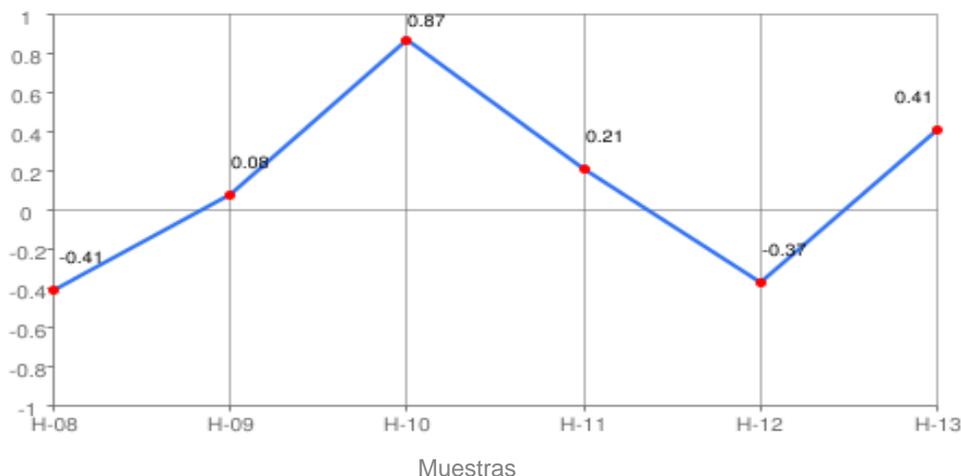


Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío	: Envío 2 de 2	Nº Evaluación	: 13
Fecha Envío	: 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe	: 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0

Gráficos Analito : Folato

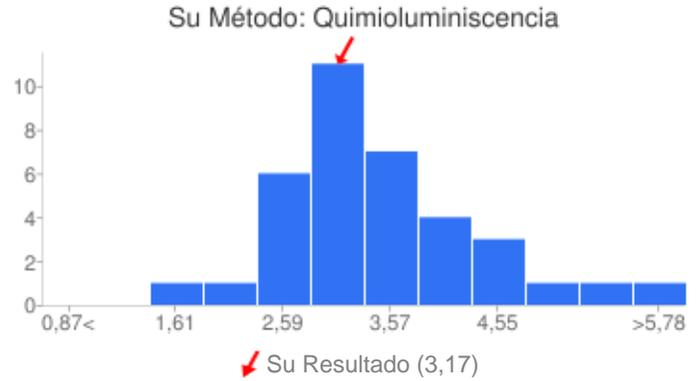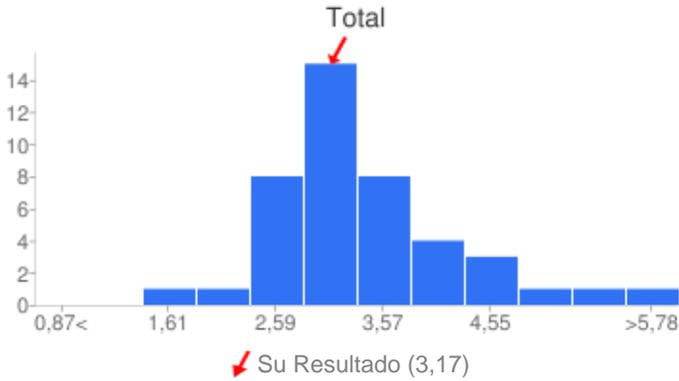

* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación

Envío : Envío 2 de 2	Nº Evaluación : 13
Fecha Envío : 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe : 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra : Suero Liofilizado	Versión del Informe : V 0


Gráficos Analito : Vitamina B12



* Buscar su grupo de equipos en informes consolidados.

Histogramas con un número de participantes <10 no se desplegarán.

Gráficos Z Históricos : Vitamina B12

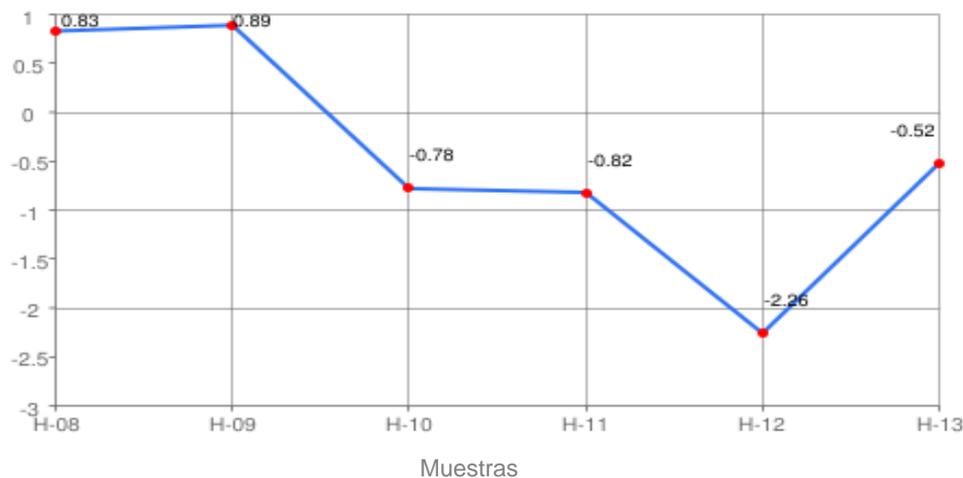

Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación		Desempeño	
Envío	: Envío 2 de 2	Nº Evaluación	: 13
Fecha Envío	: 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe	: 25 de Noviembre de 2022
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0
		Satisfactorio	IZI <= 2.0
		Cuestionable	2.0 < IZI < 3.0
		Insatisfactorio	IZI >= 3.0

Desempeño Histórico

SRZ: Evaluación del desempeño histórico del Laboratorio, y se calcula a partir del resultado de las últimas 6 evaluaciones.

Hormonas	SRZ	Desempeño Histórico
Cortisol	-0,94	Satisfactorio
Estradiol	0,25	Satisfactorio
Ferritina	-1,18	Satisfactorio
FSH	-0,04	Satisfactorio
hCG	1,39	Satisfactorio
Hormona del crecimiento (hGH)		
Insulina	-4,09	Insatisfactorio
LH	2,18	Cuestionable
Parathormona (PTH)		
Progesterona		
Prolactina	-0,58	Satisfactorio
T3 Total	0,76	Satisfactorio
T4 Libre	0,78	Satisfactorio
T4 Total	0,77	Satisfactorio
Testosterona		
TSH	0,32	Satisfactorio

Vitaminas	SRZ	Desempeño Histórico
Folato		
Vitamina B12	-1,09	Satisfactorio
Vitamina D		

Criterios para Desempeño Histórico: | SRZ | <= 2 Satisfactorio; 2 < | SRZ | < 3 Cuestionable y | SRZ | >= 3 Insatisfactorio. Donde | SRZ | = Valor absoluto de SRZ



PEEC

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Informe de Evaluación de Desempeño

Subprograma: Evaluación de Hormonas



Código de Laboratorio : 1320 HOSPITAL DE QUILPUE

Identificación de la Evaluación		Desempeño			
Envío	: Envío 2 de 2	Nº Evaluación	: 13	Satisfactorio	IZI <= 2.0
Fecha Envío	: 25 de Octubre de 2022	Fecha Entrega Informe	: 25 de Noviembre de 2022	Cuestionable	2.0 < IZI < 3.0
Tipo de Muestra	: Suero Liofilizado	Versión del Informe	: V 0	Insatisfactorio	IZI >= 3.0

Observaciones
Específicas :
Generales :

Generales : "No se evalúa el desempeño de los analitos cuando la dispersión de los datos informados es superior al requisito de calidad (Eta%) establecidos para el subprograma de Hormonas (disponible en material de Apoyo)."

La información contenida en este informe se considera confidencial, salvo las contempladas en la ley vigente.



Autorizado por:

BQ. PAOLA PELLEGRINI PINTO
JEFA SECCIÓN QUÍMICA CLÍNICA